

藥品說明書：給患者的資訊

Awikli®

700 單位/毫升

預填充注射筆注射液

insulin icodec

藥品名稱

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液 700 units/mL 1mL

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液(不附針頭)700 units/mL 1mL

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液 700 units/mL 1.5mL

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液(不附針頭) 700 units/mL 1.5mL

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液 700 units/mL 3mL

Awikli® FlexTouch® 預填充注射筆注射液(不附針頭) 700 units/mL 3mL

在您開始使用本藥物前，請仔細閱讀本說明書，因為它包含對您重要的資訊。

- 請保留本說明書，以備日後再次閱讀。
- 如有任何疑問，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士。
- 本藥物僅供您本人使用，請勿轉交他人使用。即使他人的病徵與您相同，本藥物亦可能對其造成傷害。
- 如出現任何副作用，請告知您的醫生、藥劑師或護士，包括本說明書未列明的任何可能副作用。請參閱第 4 節。

說明書內容

1. Awikli® 是什麼及其用途
2. 使用 Awikli® 前須知
3. 如何使用 Awikli®
4. 可能的副作用
5. 如何儲存 Awikli®
6. 包裝內容及其他資訊

1. Awikli® 是什麼及其用途

Awikli® 含有‘insulin icodec’，用於治療成人糖尿病。它是一種稱為「長效基礎胰島素」的胰島素。

糖尿病是一種身體無法產生足夠胰島素的疾病（胰島素是一種控制血液中血糖含量的荷爾蒙）。Awikli® 的活性成分 insulin icodec 是一種替代胰島素，其作用方式與天然產生的胰島素相同，但作用時間更長。這意味著它能產生持久而穩定的降血糖作用，因此每週只需注射一次。

2. 使用 Awikli® 前須知

請勿使用 Awikli®

- 如果您對 insulin icodec 或本藥物的任何其他成分過敏（成分列於第 6 節）。

警告及注意事項

在使用 Awikli® 前，請告知您的醫生、藥劑師或護士。

在使用 Awikli® 前，請注意以下重要事項：

- **低血糖（血糖水平過低）：**如果您的 Awikli® 劑量過高、漏餐或進行計劃外的劇烈體能運動，可能會發生低血糖。其他可能增加低血糖風險的因素包括：更換注射部位、患病（例如嘔吐、

腹瀉及發燒）、飲酒及使用其他藥物。低血糖的症狀通常會突然出現（請參閱本說明書末尾框內的資訊）。嚴重的低血糖可能導致失去知覺和／或抽搐，並可能造成暫時性或永久性腦功能損傷，甚至死亡。如果您出現低血糖，請遵循本說明書末尾框內關於血糖過低的指引。

- 如果您患有 **1 型糖尿病**，發生低血糖的機會可能更高。
- **高血糖（血糖水平過高）**：如果 **Awikli®** 的劑量不足，和／或治療中斷，或您同時患有其他疾病（特別是感染），可能會發生高血糖。高血糖的症狀通常在數小時或數天內逐漸出現（請參閱本說明書末尾框內的資訊）。未經治療的高血糖可能導致糖尿病酮症酸中毒（一種嚴重的糖尿病併發症，血液中酮體含量高）。如果您出現高血糖，請遵循本說明書末尾框內關於血糖水平過高的指引。
- **從其他胰島素藥物轉換**：如果您從每日一次或兩次的基礎胰島素轉換為每週一次的 **Awikli®**，您的醫生可能需要調整胰島素劑量。非常重要，您必須每次確認注射的劑量正確，特別是首次及第二次注射 **Awikli®** 時，因為您的醫生可能會為您的第一次注射處方較高的劑量，之後再減至較低的劑量。請務必遵循醫生關於用藥劑量的建議。請參閱第 3 節。
- 如果您同時服用 **pioglitazone** 和 **Awikli®**，若出現任何充血性心力衰竭的跡象或症狀（當心臟的泵血功能不如正常時），例如氣促、疲倦、體液滯留、體重增加及腳踝腫脹，請聯絡您的醫生。
- **眼部問題**：血糖控制的快速改善可能導致糖尿病視網膜病變（一種可引致視力喪失及失明的眼部疾病）暫時惡化。如果您有眼部問題，請告知您的醫生。
- **確保使用正確類型及劑量的胰島素**：每次注射前，請務必檢查胰島素注射筆上的標籤，以避免與其他胰島素產品混淆。如果您曾經或正在使用其他每週一次注射的糖尿病藥物，請特別注意，因為使用 **Awikli®** 注射筆選擇劑量的方式與其他每週一次注射的藥物有所不同。請務必確保您按照醫生的處方，在 **Awikli®** 注射筆上選擇正確的劑量，以避免劑量錯誤及意外過量。如果您視力不佳或視力衰退，請確保獲得另一位視力良好且經過培訓使用預填充注射筆的人士的協助。
- 切勿撥至 **Awikli®** 注射筆的最大單次劑量（**700 單位**），除非這是您的處方劑量。

注射部位的皮膚變化

應定期更換注射部位，以預防皮下脂肪組織發生變化。此類變化包括皮膚增厚、萎縮或皮下腫塊。

如果您在皮膚增厚、萎縮或有腫塊的部位注射，本藥物可能無法正常發揮效用（請參閱第 3 節「如何使用 **Awikli®**」）。如果您發現注射部位出現任何皮膚變化，或您目前正在這些受影響的部位注射，請在更換至其他部位注射前，告知您的醫生、藥劑師或護士。您的醫生、藥劑師或護士可能會建議您更頻繁地監測血糖水平，並在需要時調整您的 **Awikli®** 或其他抗糖尿病藥物的劑量。

胰島素抗體

使用 **Awikli®** 治療可能導致身體產生胰島素抗體（可能影響胰島素治療效果的分子）。這極少情況下可能需要您更改胰島素劑量。

兒童及青少年

請勿將本藥物給予 0 至 18 歲的兒童及青少年使用，因為目前尚無在兒童或青少年中使用 **Awikli®** 的經驗。

其他藥物與 **Awikli®**

請告知您的醫生、藥劑師或護士您正在服用、最近曾服用或可能服用的任何其他藥物。某些藥物會影響您的血糖水平，這可能意味著需要調整您的 **Awikli®** 劑量。

以下列出最常見的可能影響您使用 **Awikli®** 治療的藥物。

您可能需要較低的劑量／血糖水平可能下降（低血糖），如果您同時服用：

- 其他糖尿病藥物（口服或注射）
- 磺胺類藥物，用於治療感染

- 合成代謝類固醇，例如睪酮
- 用於高血壓的乙型阻斷劑（ β -blockers），這些藥物可能使您更難察覺血糖過低的警告跡象（請參閱本說明書末尾框內的資訊：血糖過低的警告跡象）
- 乙醯水楊酸（及其他水楊酸鹽類），用於止痛及輕微發燒
- 單胺氧化酶（MAO）抑制劑，用於治療抑鬱症
- 血管緊張素轉化酶（ACE）抑制劑，用於某些心臟問題或高血壓

您可能需要較高的劑量／血糖水平可能上升（高血糖），如果您同時服用：

- danazol，用於治療子宮內膜異位症
- 口服避孕藥（避孕藥丸）
- 甲狀腺荷爾蒙，用於甲狀腺問題
- 生長荷爾蒙，用於生長荷爾蒙缺乏症
- 糖皮質激素，例如可的松，用於消炎
- 擬交感神經藥，例如腎上腺素（epinephrine）、沙丁胺醇（salbutamol）或特布他林（terbutaline），用於哮喘
- 噁嗪類藥物，用於高血壓或體內水分滯留（水腫）

Octreotide 及 lanreotide（用於治療一種涉及過多生長荷爾蒙的罕見疾病（肢端肥大症））可能使您的血糖水平升高或降低。

Pioglitazone（一種口服治療 2 型糖尿病的糖尿病藥物）。部分患有長期 2 型糖尿病及心臟病或曾有中風，同時接受 pioglitazone 及胰島素治療的患者出現心力衰竭。

- 如果您出現心力衰竭的跡象，例如氣促、疲倦、體液滯留、體重增加及腳踝腫脹，請立即告知您的醫生。

如果以上任何情況適用於您（或您不確定），請在注射 **Awikli®** 前告知您的醫生、藥劑師或護士，因為每週胰島素與其他藥物相互作用的劑量調整方式可能有所不同。

Awikli® 與酒精

如果您飲酒，您所需的 **Awikli®** 劑量可能會有所變化。您的血糖水平可能升高或降低。這意味著您在飲酒時需要比平時更頻繁地檢測血糖水平。

懷孕及哺乳

目前尚不清楚 **Awikli®** 是否會對胎兒造成影響。因此，如果您是有生育能力並計劃懷孕的女性，應停止使用本藥物。如果您在使用本藥物期間懷孕，請聯絡您的醫生尋求指引。

目前尚不清楚本藥物是否會通過人乳排出，且無法排除對嬰兒的風險。因此，哺乳期間不應使用 **Awikli®**，並且必須決定是否停止使用本藥物或避免哺乳。

駕駛及操作機械

Awikli® 對駕駛及操作機械的能力影響極小或沒有影響，但它會改變您的血糖水平。血糖過低或過高可能影響您駕駛或使用任何工具或機械的能力。如果您的血糖過低或過高，您的專注力或反應能力可能受到影響，這可能對您自己或他人造成危險。如果有以下情況，請向您的醫生或護士尋求指引：

- 您經常出現血糖過低的情況
- 您難以察覺血糖過低的徵狀

關於 **Awikli® 部分成分的重要資訊**

本藥物每劑量含有少於 1 毫摩爾（23 毫克）的鈉，即基本上「不含鈉」。

3. 如何使用 **Awikli®**

Awikli® 每週注射一次。

請務必完全按照醫生的指示使用本藥物。如有疑問，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士。

Awikli® 是一種長效胰島素，可與短效或速效胰島素合併使用。

在 2 型糖尿病中：

- Awikli® 可與口服或注射糖尿病藥物合併使用，包括短效或速效胰島素。

在 1 型糖尿病中：

- Awikli® 必須始終與短效或速效胰島素合併使用。
- 如果您是新確診的 1 型糖尿病患者（尚未接受胰島素治療），Awikli® 並不適合您。

如果您視力不佳或視力衰退，無法閱讀注射筆上的劑量顯示器，請勿在無人協助的情況下使用本注射筆。請尋求視力良好且經過培訓使用預填充注射筆的人士的協助。

注射筆的內容

預填充注射筆可在單次注射中以 10 單位為步進提供 10 至 700 單位的劑量。

- Awikli® 700 單位/毫升（1 毫升）含 700 單位
- Awikli® 700 單位/毫升（1.5 毫升）含 1,050 單位
- Awikli® 700 單位/毫升（3 毫升）含 2,100 單位

預填充注射筆的劑量顯示器顯示您應注射的胰島素單位數。因此，請勿進行任何劑量換算。700 單位/毫升預填充注射筆可在單次注射中以 10 單位為步進提供 10 至 700 單位的劑量。

何時使用 Awikli®

Awikli® 是每週使用一次的基礎胰島素。

- 您應每週在同一天注射 Awikli®。
- 您可以在一天中的任何時間注射本藥物。

注射劑量

您的醫生將與您共同決定：

- 您每週需要多少 Awikli®
- 何時檢測您的血糖水平
- 何時需要增加或減少劑量——您的醫生可能會根據您的血糖水平調整劑量
- 使用其他藥物時是否需要調整治療方案

從每日一次或兩次基礎胰島素轉換時的劑量

您每週一次的 Awikli® 劑量取決於您目前的基礎胰島素劑量。您的醫生將為您處方能覆蓋您每週基礎胰島素需求的劑量。

- 僅在第一次注射時，您可能需要服用較高的 Awikli® 劑量。此劑量僅適用於第一次注射；請勿在第二次及以後的注射中使用此劑量。請與您的醫生討論您的第一次注射應使用多少劑量。
- 您的劑量應根據您的血糖測量結果而定。您的醫生將與您共同決定每週的 Awikli® 劑量。
- 建議在轉換期間及之後數週內密切監測血糖。

老年人使用（65 歲及以上）

Awikli® 可供老年人使用。

腎臟或肝臟問題患者

如果您有腎臟或肝臟問題，您可能需要更頻繁地檢測血糖水平。

注射 Awikli® 前

在您首次使用 **Awikli®** 前，請閱讀本包裝附帶的使用說明。請檢查注射筆標籤上的名稱，確認它是 **Awikli® 700 單位/毫升**。

注射方式

- 將 **Awikli®** 注射於皮下（皮下注射），請勿注射入靜脈或肌肉。
- 最佳注射部位為大腿、上臂或腹部。
- 每次更換注射部位，以降低出現皮膚腫塊及皮膚凹陷的風險（請參閱第 2 節）。
- 每次注射時均使用新針頭，以降低污染、感染及針頭堵塞的風險，確保劑量準確。每次使用後安全棄置針頭。
- 請勿使用注射器從注射筆中抽取藥液，以避免劑量錯誤及可能的過量注射。

詳細使用說明見本說明書另一面。

以下情況請勿使用 **Awikli®**

- 用於胰島素輸液泵
- 注射筆已損壞或儲存不當（請參閱第 5 節）
- 藥液含有可見顆粒—藥液應為清澈無色

如果您使用了過多 **Awikli®**

如果您使用了過多本藥物，您的血糖可能會過低（低血糖）。請參閱本說明書末尾框內的指引——血糖過低（低血糖）。

如果您忘記使用 **Awikli®**

如果您是 1 型糖尿病患者：

- 一旦想起，立即注射。然後在注射遺漏劑量後一週再次注射 **Awikli®**。這天將成為您新的每週注射日，之後繼續每週注射一次。
- 如果您希望恢復原來的注射日，可在與醫生商議後，通過延長下一次劑量之間的時間來實現。
- 如果您不確定何時服藥，請諮詢您的醫生或藥劑師。

如果您是 2 型糖尿病患者：

- 如果距您應注射 **Awikli®** 的時間不超過 3 天，請立即注射。然後在您常規的注射日注射下一劑量。
- 如果距您應注射 **Awikli®** 的時間超過 3 天，請立即注射。您應在注射遺漏劑量後一週注射下一劑 **Awikli®**。如果您希望恢復原來的注射日，可在與醫生商議後，通過延長下一次劑量之間的時間來實現。
- 之後繼續每週注射一次。
- 如果您不確定何時服藥，請諮詢您的醫生或藥劑師。

如果您停止使用 **Awikli®**

請勿在未諮詢醫生的情況下停止使用 **Awikli®**。如果您停止使用本藥物，可能導致血糖水平非常高（高血糖）及酮症酸中毒（一種血液中酸性過高的情況）。請參閱本說明書末尾框內的建議——血糖過高（高血糖）。

4. 可能的副作用

與所有藥物一樣，本藥物可能引起副作用，但並非所有人會出現。

低血糖（血糖過低）—十分常見（可能影響超過十分之一的人）

- 低血糖可能非常嚴重。
- 如果您的血糖水平下降過多，您可能會失去知覺。

- 嚴重的低血糖可能導致腦損傷，並可能危及生命。

如果您出現血糖過低的跡象，請立即嘗試提升您的血糖水平。請參閱下方「血糖過低（低血糖）」的建議。

過敏反應—不常見（可能影響最多百分之一的人）

嚴重過敏反應的跡象包括：

- 感覺不適（頭暈）
- 呼吸困難
- 心跳加速或感到頭暈
- 噁心及嘔吐
- 局部反應，例如皮疹、腫脹或搔癢，並蔓延至身體其他部位
- 出汗及失去知覺

如果您對 **Awikli®** 出現嚴重過敏反應，請立即停止使用本藥物並就醫。若喉嚨腫脹阻塞氣道，嚴重過敏反應可能危及生命。

注射部位的皮膚變化—罕見（可能影響最多千分之一的人）

- 如果您在同一部位注射過於頻繁，皮膚可能會萎縮（脂肪萎縮）或增厚（脂肪肥大）。
- 如果您經常在同一部位注射胰島素，皮下腫塊也可能由一種稱為澱粉樣蛋白的蛋白質堆積（皮膚澱粉樣變性）引起，發生頻率目前尚不清楚。
- 如果您在有腫塊、萎縮或增厚的部位注射，本藥物可能無法很好地發揮效用。
- 每次注射時更換注射部位，以預防這些皮膚變化。

其他副作用包括：

常見（可能影響最多十分之一的人）

- 注射部位的皮膚問題，例如瘀傷、出血、疼痛或不適、泛紅、腫脹、搔癢。
- 周邊水腫（尤其是腳踝和腳部因體液滯留引起的腫脹）。

副作用報告

如果您出現任何副作用，請告知您的醫生、藥劑師或護士，包括本說明書未列明的任何可能副作用。通過報告副作用，您可以協助提供有關本藥物安全性的更多資訊。

5. 如何儲存 Awikli®

請將本藥物存放於兒童視線及觸及範圍之外。

請勿在注射筆標籤及包裝盒上「有效期至」後標明的有效期過後使用本藥物。有效期是指該月的最後一天。

首次使用前

儲存於雪櫃中(攝氏 2 度-8 度)。

勿結冰，並遠離結冰物件。

請蓋上注射筆筆帽以防止光線照射。

首次開封後或作備用攜帶時

儲存於攝氏 30 度以下，可儲存於雪櫃中(攝氏 2 度-8 度)，於 12 星期內使用。

不使用時，請務必蓋上注射筆筆帽以防止光線照射。

請勿將任何藥物棄置於廢水或家居廢物中。請詢問藥劑師如何棄置不再使用的藥物，以保護環境。

6. 包裝內容及其他資訊

Awikli® 的成分

- 活性成分為 insulin icodec。每毫升藥液含 700 單位 insulin icodec。每支預填充注射筆分別含有 700、1,050 或 2,100 單位 insulin icodec，藥液體積分別為 1、1.5 或 3 毫升。
- 其他成分為甘油、間甲酚、苯酚、醋酸鋅、氯化鈉、鹽酸及氫氧化鈉（用於調節 pH 值）及注射用水（請參閱第 2 節）。

Awikli® 的外觀及包裝內容

Awikli® 為預填充注射筆中的清澈無色注射液。

外包裝為綠色，強度「700 單位/毫升」以黃色框標示。注射筆筆身為綠色，而注射筆標籤為深綠色，黃色框標示製劑強度。

包裝規格

Awikli® 預填充注射筆於 1 毫升藥液中含 700 單位 insulin icodec.

- 1 預填充注射筆（不含針頭）
- 1 預填充注射筆（附 9 支一次性 NovoFine® Plus 針頭）

Awikli® 預填充注射筆於 1.5 毫升藥液中含 1 050 單位 insulin icodec.

- 1 預填充注射筆（不含針頭）
- 1 預填充注射筆（附 13 支一次性 NovoFine® Plus 針頭）

Awikli® 預填充注射筆於 3 毫升藥液中含 2 100 單位 insulin icodec.

- 1 預填充注射筆（不含針頭）
- 1 預填充注射筆（附 13 支一次性 NovoFine® Plus 針頭）

並非所有包裝規格均有上市銷售。

製造商

Novo Nordisk A/S Novo Alle 1 DK-2880 Bagsvaerd Denmark

Awikli®、FlexTouch®、NovoFine® 及 NovoTwist® 均為 Novo Nordisk A/S（丹麥）擁有的商標。

© 2025 Novo Nordisk A/S

Front page information:

患者資訊及
使用說明

Awikli®
FlexTouch®
(insulin icodec)
注射液
700 單位/毫升

注射筆每次
注射可提供
10 至 700 單位
每週注射一次

高血糖及低血糖

糖尿病治療的一般影響

血糖過低（低血糖）

以下情況可能導致低血糖：

- 飲酒
- 使用過多胰島素
- 運動量比平時多
- 進食過少或漏餐

血糖過低的警告跡象—這些跡象可能突然出現：

- 頭痛
- 心跳加速
- 感到噁心或非常飢餓
- 冒冷汗或皮膚冰涼蒼白
- 短暫視力變化
- 顫抖或感到緊張或焦慮
- 感到異常疲倦、虛弱及睏倦
- 口齒不清、感到混亂、難以集中注意力

如果您出現血糖過低，應採取的措施：

- 服食葡萄糖片或其他高糖分零食，例如糖果、餅乾或果汁（請隨時備有葡萄糖片或高糖分零食，以備不時之需）。
- 如有可能，測量血糖並休息。您可能需要多次測量血糖，因為使用 **Awicli®** 等基礎胰島素後，血糖升高的速度可能較慢。
- 等待血糖過低的症狀消退或血糖水平穩定後，繼續按常規注射胰島素。
- 如果您患有 1 型糖尿病並多次出現血糖過低的情況，應諮詢您的醫生。

如果您失去知覺，他人需要採取的措施

請告知您所有相處的人您患有糖尿病。告訴他們如果您的血糖過低可能發生什麼情況，包括失去知覺的風險。

告知他們，如果您失去知覺，他們必須：

- 將您側臥
- 立即尋求醫療協助
- 不要給您任何食物或飲料，因為您可能會噎到

注射胰高血糖素可能有助您更快從失去知覺中恢復。這只能由知道如何使用的人來注射。

- 如果您被注射了胰高血糖素，一旦您甦醒後，您需要立即服用糖分或含糖零食。
- 如果您對胰高血糖素沒有反應，您將需要在醫院接受治療。

如果嚴重的低血糖長時間未獲治療，可能導致腦損傷，損傷可以是短暫的或長期的，甚至可能導致死亡。

如有以下情況，請告知您的醫生：

- 您的血糖曾低至失去知覺
- 您曾使用胰高血糖素
- 您近期曾多次出現血糖過低的情況

這是因為您的胰島素注射劑量、飲食或運動可能需要調整。

血糖過高（高血糖）

以下情況可能導致高血糖：

- 飲酒
- 感染或發燒
- 使用的胰島素劑量不足
- 進食增多或運動減少
- 持續使用比所需更少的胰島素
- 忘記使用胰島素或在未諮詢醫生的情況下停止使用胰島素

血糖過高的警告跡象——這些跡象通常逐漸出現：

- 感到口渴
- 皮膚潮紅或乾燥
- 失去食慾
- 感到困倦或疲倦
- 更頻繁地排尿
- 口乾或呼氣有果香（丙酮）味
- 感到噁心或嘔吐

這些可能是一種非常嚴重的病症——酮症酸中毒的跡象。這是由於身體分解脂肪而非糖分，導致血液中酸性積聚。若不治療，可能導致糖尿病昏迷，甚至死亡。

如果您出現血糖過高，應採取的措施：

- 測試您的血糖水平
- 測試您的尿液或血液中的酮體
- 立即尋求醫療協助

使用說明

在您開始使用針頭及 **Awikli®** 注射筆前，請務必仔細閱讀以下說明，並與您的醫生、護士或藥劑師討論如何正確注射 **Awikli®**。

Awikli® 注射筆是一款含有 insulin icodec 700 單位/毫升的預填充一次性注射筆。您可以在每週一次的單次注射中注射 10 至 700 單位。

使用前請先檢查注射筆標籤，確認它含有 **Awikli® 700 單位/毫升**。

您的注射筆設計用於搭配長度最長為 8 毫米的 NovoFine® Plus、NovoFine® 或 NovoTwist® 一次性針頭使用。

每週注射一次

Awikli® 注射筆


請注意：您的注射筆尺寸可能與圖示中的注射筆有所不同。本說明適用於所有 **Awikli®** 注射筆。







關於您的針頭

每次注射時請使用新針頭。如「步驟 2」所述檢查藥液流量，並為每次注射使用新針頭。每次使用後請務必取下針頭。


NovoFine® Plus 針頭（示例）



步驟 1：為注射筆安裝新針頭


• 用肥皂及清水清潔雙手。 • 檢查注射筆標籤上的名稱及濃度，確認您的注射筆含有 insulin icodec 700 單位/毫升。 • 取下筆帽（見圖 A）。	
• 請務必確認注射筆中的胰島素清澈無色。 • 透過注射筆視窗觀察。如果胰島素看起來混濁或含有顆粒，請勿使用（見圖 B）。	
• 每次注射時請使用新針頭。 • 檢查紙質封條及外針帽是否有損壞，如發現任何損壞，可能影響無菌性，請棄置該針頭並使用新針頭。 • 取一支新針頭並撕去紙質封條。 • 在準備好注射之前，請勿將新針頭安裝至注射筆上（見圖 C）。	
• 將針頭筆直推入注射筆，然後旋緊（見圖 D）。 • 針頭由兩個針帽覆蓋，您必須取下兩個針帽。如果忘記取下兩個針帽，將無法注射任何 Awiqli®。	

- 取下外針帽並保留備用，完成注射後需用它安全取下針頭（見圖 E）。
- 取下內針帽並棄置（見圖 F）。
- 針頭尖端可能出現一滴 **Awikli®**，這是正常的，但每次注射前您仍必須檢查 **Awikli®** 的流量（見「步驟 2」）。
- 請勿使用彎曲或損壞的針頭。



步驟 2：每次注射前檢查藥液流量

- 每次注射前請務必檢查藥液流量，以確保您能獲得完整的 **Awikli®** 劑量。
- 順時針旋轉劑量選擇器，直至劑量顯示器顯示第一個刻度（10 單位）（見圖 G）。
- 確保刻度與劑量指針對齊（見圖 H）。




- 將注射筆針頭朝上握持。
- 按住劑量按鈕，直至劑量顯示器顯示「0」，「0」必須與劑量指針對齊。
- 針頭尖端應出現一滴 Awiqli®，此滴表示注射筆已準備好使用（見圖 I）。
- 如果沒有出現藥滴，請再次檢查藥液流量，最多可重複此步驟六次。
- 如果仍未出現藥滴，針頭可能已堵塞，請按「步驟 5」和「步驟 1」所述更換針頭。
- 然後再次檢查藥液流量。
- 如果 Awiqli® 藥滴仍未出現，請勿使用注射筆。




步驟 3：設定劑量

- 確認劑量指針設置在「0」（見圖 J）。
- 轉動劑量選擇器，選擇您的護士或醫生指示需要注射的單位數，劑量顯示器將顯示撥定的劑量單位數。
- 請確保您選擇了預期的劑量。



- 劑量顯示器中顯示的單位數將引導您至您的劑量，劑量可以每次增加 10 單位。 - 每次轉動劑量選擇器時，您將聽到「喀嗒」聲。請勿通過計算聽到的「喀嗒」聲次數來設定劑量。 - 如果您選錯了劑量，可以向前或向後轉動劑量選擇器至正確劑量。 - 當您的劑量與劑量指針對齊時，即表示您已選定劑量。請確保您選擇了預期的劑量。 - 圖示展示如何正確選擇劑量的示例（見圖 K）。 - 如果劑量顯示器在您達到處方劑量前停止，請參閱以下「您的 Awiqli® 是否足夠？」部分。	K 
選擇注射部位 - 在您的腹部（距肚臍 5 厘米範圍以外）、大腿上部或上臂選擇注射部位。 - 您可以每週在同一身體區域注射，但請確保不是在上次注射的相同位置。 - 用酒精棉片清潔注射部位。清潔後不要觸摸注射部位。	
步驟 4：注射劑量	
- 將針頭完全插入皮膚（見圖 L）。 - 請確保您能看到劑量顯示器。請勿遮蓋劑量顯示器或用手指觸碰，否則可能中斷注射。	L 

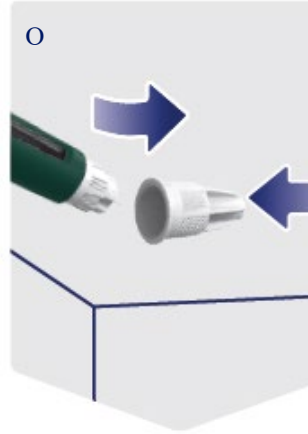• 按住劑量按鈕，直至劑量顯示器顯示「0」。 • 繼續按住劑量按鈕，針頭留在皮膚內，緩慢數至 6。「0」必須與劑量指針對齊（見圖 M）。當劑量顯示器歸回「0」時，您可能會聽到或感到「喀嗒」聲。	M 
• 從皮膚中取出針頭後，方可放開劑量按鈕（見圖 N）。 • 如果針頭過早取出，Awikli® 可能從針頭尖端流出，導致無法完整注射劑量。 • 如果注射部位出現血液，請以棉花或紗布輕按。 • 注射後針頭尖端可能出現一滴 Awikli®，這是正常的，不會影響您的劑量。	N 
步驟 5：注射後	
• 在平坦的表面上小心將針頭尖端插入外針帽，不要觸碰針頭或外針帽（見圖 O）。 • 一旦針頭被覆蓋，小心地將外針帽完全推上。	O 

- 旋下針頭，按照醫生、護士、藥劑師或當地相關部門的指示安全棄置（見圖 P）。
- 切勿嘗試將內針帽重新蓋回針頭，否則您可能被針頭刺傷。
- **每次注射後立即取下並棄置針頭**，以防止污染、感染、針頭堵塞及劑量不準確。
- 切勿在安裝針頭的情況下存放注射筆。




- 每次使用後，**將筆帽蓋回注射筆**，以保護 Awiqli® 免受光線照射（見圖 Q）。
- 當注射筆用盡後，請按照醫生、護士、藥劑師或當地相關部門的指示，在不安裝針頭的情況下棄置注射筆。
- 說明書及空包裝盒可作家居廢物棄置。



您的 Awiqli® 是否足夠？

- 如果劑量顯示器在您達到劑量前停止，則注射筆內的 Awiqli® 不足以完成完整劑量。劑量顯示器中顯示的數字即為注射筆中剩餘的單位數。
- 如果您需要的 Awiqli® 比注射筆中剩餘的更多，您可以將劑量分成兩支注射筆注射。如果您分開劑量，請務必計算正確。如有疑問，棄置已使用的注射筆，並用新注射筆注射完整劑量。
- 如果分開劑量計算有誤，您將注射過少或過多的 Awiqli®，可能導致血糖水平過高或過低。



重要資訊

- **針頭僅供一次性使用。** 切勿重複使用針頭，以降低污染、感染、胰島素洩漏、針頭堵塞及劑量不準確的風險。
- **請妥善保管注射筆。** 粗暴使用或操作不當可能導致劑量不準確，從而引致血糖水平過高或過低。
- **護理人員在處理針頭時必須非常小心**，以防意外針刺傷及感染。
- **如果您視力不佳且無法遵循以下說明，請勿在無人協助的情況下使用本注射筆。** 請尋求視力良好且經過培訓使用 Awikli® 注射筆的人士的協助。
- **請務必將注射筆及針頭存放於他人（尤其是兒童）視線及觸及範圍之外。**
- **每週注射一次 Awikli®。**
- **按處方使用您的 Awikli®。** 如果您未按處方使用，可能導致血糖水平過高或過低。
- **如果您使用多種注射藥物，在使用前務必核對注射筆標籤上的名稱及濃度，這一點非常重要。**
- **切勿與他人共用您的注射筆或針頭。**

注射筆的保養

- **請勿冷凍 Awikli®。** 請勿使用已冷凍的 Awikli®，請棄置該注射筆。
- 請勿摔落注射筆或將其碰撞在堅硬的表面上。
- 避免將 Awikli® 暴露於直射陽光下。
- 請將 Awikli® 遠離熱源、微波爐及光線。
- 請勿嘗試修理注射筆或將其拆開。
- 請勿讓注射筆接觸灰塵、污垢或液體。
- 請勿清洗、浸泡或潤滑注射筆，可用沾有溫和清潔劑的濕布擦拭。
- 請參閱本說明書背面了解注射筆的儲存條件。